

VOICEJOURNAL - Nyhetsbrev

Full fart ut ur pandemin


Alla har vi drabbats av pandemin i olika omfattning. Vi har dock inte vilat på lagrarna under de senaste åren och vi står nu fullt rustade att möta våra kunders nya behov.

Under de senaste åren har vi utvecklat produkterna för att underlätta arbetet. Vi har också ersatt gamla ljudkort och uppdaterat databaslösningen hos flera kunder för att hantera kraven med som följer med nya versioner av Windows.

Till hösten ser vi fram emot att möta våra användare då vi ställer ut som huvudpartner för Nationell Konferens i Logopedi.

Nya produkter och operativsystem

I november 2019 släppte vi den certifierade versionen för Windows 10, build 1065. Därefter har upgraderat utvecklingsmiljön och utvecklat ett antal nya funktioner som ska göra arbetet smidigare. Det är framförallt möjligheten att få mätvärden automatiskt lagrade i casen och skicka dem tillbaka till journalsystemet.

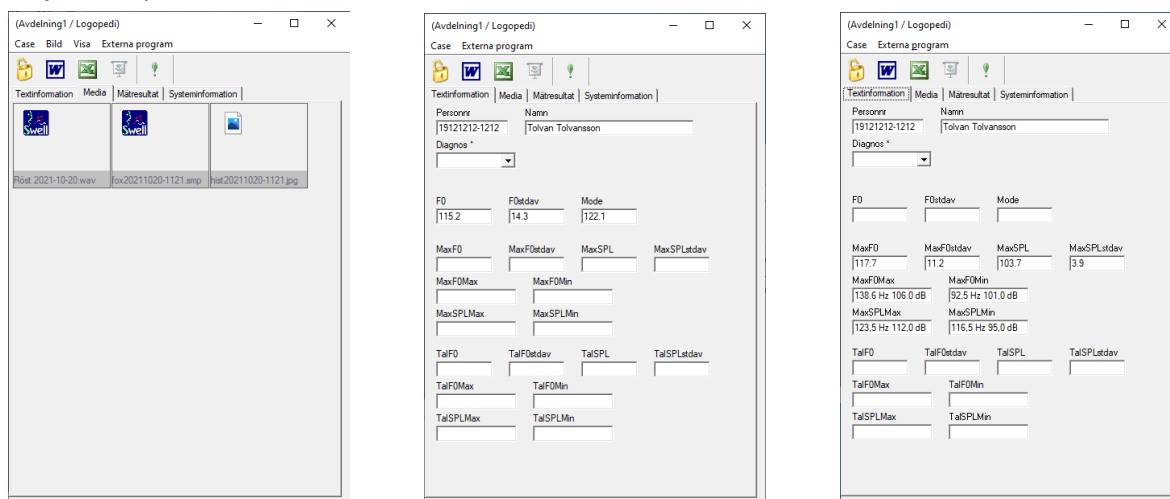

Serveruppdateringar

Sjukvårdens IT-system uppdateras kontinuerligt och blir mer komplexa med högre säkerhetskrav. De äldre versionerna av VoiceJournal-databasen är inte certifierad för de nyare Windows server och SQL-servrarna. Det innebär att uppdateringar blir mer omfattande, involverar fler personer och genomförandet måste planeras noga. Under det senaste året har vi fått många nyttiga erfarenheter på hur upplägget blir bäst. Har ni inte redan uppdaterat är det dags. Vårt mål är att det stora flertalet av våra användare har en miljö fullt integrerad med journalsystemet och VoiceJournal/Picsara 10.X med de senaste programversionerna.

Externa ljudkort

Utvecklingen av de externa ljudkorterna fortsätter och vissa går ur tiden. Det gäller speciellt när drivrutinerna inte längre uppdateras. Samtidigt kommer nya produkter och vi har nu nya "favoriter", ljudkort som är ordentligt testade för att uppfylla kraven inom logopedi och enkelt handhavande. För

NEOVIUS

DATA OCH SIGNALSYSTEM AB

behandlingsrum, nivå 2, rekommenderar vi Focusrite Scarlett Solo. För studio, nivå 3, krävs Focusrite Scarlett 2i2.



Focusrite Scarlett, Mono till vänster, 2i2 till höger.

Kostnaden för enheterna är inte särskilt stor. Om det uppstår problem med drivrutiner för de äldre korten eller att datorn kraschar redan vid uppstart är utbyte den enklaste och billigaste lösningen.

Nationell Konferens i Logopedi 10-11 november 2022



Vi är stolta och glada att kunna berätta Neovius Data och Signalsystem AB är huvudpartner till NKL2022 i november. Vi kommer att finnas på plats med en utställning av våra produkter och finnas tillgängliga för diskussion om både införda och föreslagna nyheter och förbättringar.

Med vänlig hälsning
Lennart Neovius

Våra samarbetspartners

PEAK NETWORKS AB

Peaky Networks AB står för installation, underhåll och driftstöd av serverdelen (baserad på Picsara från CSam Health)

fastdev

WORLD CLASS SOFTWARE DEVELOPMENT

FastDev är vår huvudpartner för programmering av våra användarprogram.

NEOVIUS Data och Signalsystem AB
Lillåkersvägen 23
181 59 LIDINGÖ

Telefon: 08-38 23 98
Mobil: 0708-38 52 08
E-mail: info@neovius.se
Web: www.neovius.se

Bankgiro: 549-2210
Org-nr: 556973-5326